Table des matières:

Introduction ... 2
Légende ... 2
Indication ... 2
Contre- indication ... 2
Domaine d'utilisation ... 2
Stérilisation ... 2
Allergie ... 2
Remarque ... 2
Description du système ... 3
Marche à suivre lors de positions divergentes d'implants ... 3
Agencement de la base prothétique avec composants d'ancrage (prothèse hybride) ... 3
Le système en aperçu ... 4
Composants individuels de Novaloc™ ... 4
Instruments Novaloc™ ... 5
Novaloc™- accessoirs spéciaux ... 5
Composants du système Novaloc™ ... 6
Préparation/ Stérilisation ... 7
Désinfection ... 7
Stérilisation ... 7
Risques ... 8
Risques lors de la préparation/stérilisation ... 8
Risques avec le système Novaloc™ ... 8
Utilisation des instruments Novaloc™ ... 8
Utilisation des composants Novaloc™ ... 8
Marche à suivre ... 9
Boîtier de la matrice Novaloc™ (titane/ PEEK) ... 9
Unité de montage Novaloc™ (PEEK/ couleur noire) ... 9
Unités de rétention Novaloc™ (PEEK) ... 11
Matrice d'empreinte/fixation Novaloc™ (PEEK/ rouge) ... 12
Insert de doublage Novaloc™ (POM C/ blanc) ... 12
Disque de montage Novaloc™ (silicone/ couleur blanche) ... 13
Analogue Novaloc™ (aluminium/ couleur bleue) ... 13
Extracteur Novaloc™ pour boîtier de matrice + dispositif de retrait (gris)-uniquement pour boîtier titane- ... 14
Boîte d'équipement Novaloc™ avec son contenu initial ... 15
Novaloc™- accessoirs spéciaux ... 15
Légende matériaux ... 16

[1]LOCATOR® est une marque déposée de la société Zest Anchors LLC.

INTRODUCTION

La description du produit / le mode d'emploi ci-dessous est complémentaire à la notice d'emballage du système de matrice Novaloc™.

Les instructions ci-après doivent être respectées strictement pour assurer un fonctionnement irréprochable du système.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de la non-observation de ce mode d'emploi.

Légende

CE	Conformité symbol		Ne pas réutiliser
	Fabricant de	REF	le numéro de l'article
NON STERILE	Non-stérilisation	LOT	Code du lot
	Mode d'emploi		

Indication

Le système de matrice Novaloc™ peut être utilisé dans une prothèse partielle ou hybride compatible avec Novaloc™, nouvelle ou déjà existante.

Contre- indication

Le système de matrice Novaloc™ ne peut pas être utilisé lors d'une divergence de plus 40° entre les implants.

Domaine d'utilisation

Médecine dentaire

Stérilisation

Le produit est fourni NON STÉRILE.
Chaque reconstruction prothétique doit être lavée et désinfectée avant toute utilisation.

Allergie

Ce produit ne doit pas être employé chez des patients susceptibles de présenter une allergie à un ou plusieurs composants du matériau utilisé.
Le produit ne doit être utilisé qu'après un bilan allergologique, si une absence d'allergie est mise en évidence.

Remarque

Le nettoyage mécanique du produit à l'aide d'une brosse à dents et de dentifrice peut provoquer une usure prématurée des zones fonctionnelles.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Le système de matrice Novaloc™, avec sa technologie nouvellement développée, est un élément de connexion fabriqué pour fixer une prothèse dentaire amovible sur boutons pression Locator® / piliers Locator®.

La matrice Novaloc™ est composée d'un boîtier (au choix en titane ou en PEEK) et de quatre éléments de rétention changeables en matière synthétique (PEEK), disponibles en quatre degrés de résistance identifiables par un code couleurs.

La connexion par emboîtement de la matrice™ avec le bouton-pression Locator® repose sur le mécanisme d'emboîtement de l'élément de rétention sur la zone fonctionnelle du bouton-pression Locator®. En particulier à cause de la construction de l'élément de rétention et à cause de l'utilisation de PEEK en tant que matériau, la matrice Novaloc™ permet des restaurations sans phénomène d'usure des éléments de rétention même dans le cas de plusieurs positions de piliers extrêmement divergentes l'une par rapport à l'autre.

La zone de dilatation construite entre la matrice et l'élément de rétention permet une extension de l'élément de rétention sans aucune contrainte et prolonge ainsi considérablement la durée de vie de l'élément de rétention.

L'équipement spécial pour l'utilisation de Novaloc™ par le dentiste et le technicien-dentiste a été conçu en fonction de la pratique avec inclusion de tous les composants nécessaires du système et de l'outillage à utiliser.

Un outil absolument spécifique pour Novaloc™ est l'instrument indispensable de mise en place et de retrait pour les éléments de rétention, permettant une mise en place, un remplacement ou un changement des éléments de rétention sans aucune contrainte grâce à une technologie particulière.

Marche à suivre lors de positions divergentes d'implants



Fig. 1

Le système de matrice Novaloc™ offre la possibilité d'intégrer la prothèse dentaire sur des implants inclinés jusqu'à un angle de 20°. On peut ainsi corriger des divergences allant jusqu'à 40° au maximum entre deux implants [Fig.1].

On peut utiliser pour cela – sans utilisation de piliers coudés – les quatre éléments de rétention Novaloc™ classés par force de rétention et identifiés par un code couleurs.

Agencement de la base prothétique avec composants d'ancrage (prothèse hybride)



Fig.2

Attention

En présence de divergences de la crête alvéolaire par rapport à l'axe de la matrice Novaloc™, les bords concernés de la prothèse doivent impérativement être réduits, de sorte à correspondre à l'équateur de l'implant [Fig.2].

Cette procédure est **obligatoire** quel que soit le type d'implants hybrides, la prothèse pouvant être utilisée en association avec les éléments de maintien sans contrainte.

LE SYSTÈME EN APERÇU

Composants individuels de Novaloc™

Image	Réf.	Désignation	Spécifications	Nombre
	2010.701	**Boîtier de matrice en titane** (avec unité de montage en noir)  -désinfectable-	Matrice: titane Unité de montage: PEEK	4 pces
	2010.702	**Boîtier de matrice en PEEK** (avec unité de montage noire)  -désinfectable-	Matrice: PEEK Unité de montage: PEEK	4 pces
	2010.711	**Élément de rétention blanc** -désinfectable-	PEEK (P) Force de retention: ***light***	4 pces
	2010.712	**Élément de rétention jaune** -désinfectable-	PEEK (P) Force de retention: ***medium***	4 pces
	2010.713	**Élément de rétention vert** -désinfectable-	PEEK (P) Force de retention: ***strong***	4 pces
	2010.714	**Élément de rétention bleu** -désinfectable-	PEEK (P) Force de retention: ***extra-strong***	4 pces
	2010.721	**Analogue, Ø4, bleu** -désinfectable-	Aluminium	4 pces
	2010.722	**Matrice d'empreinte/ fixation rouge**  -désinfectable-	PEEK	4 pces
	2010.723	**Insert de doublage, blanc**  -désinfectable-	POM C	4 pces
	2010.724	**Anneau de montage en silicone** - désinfectable -	Silicone	10 pces
	2010.725	**Unité de montage noire** - désinfectable -	PEEK	4 pces

Instruments Novaloc™

Image	Réf.	Désignation	Spécifications	Nombre
	2010.731	**Instrument de retrait des unités de montage + instrument facilitant le repositionnement des analogues (bleu)** - stérilisable -	Aluminium, acier	1 pce
	2010.741	**Instrument de mise en place et de retrait des unités de rétention (brun)** - stérilisable -	Aluminium, acier	1 pce
	2010.751	**Extracteur de boîtier de matrice (gris)** - stérilisable -	Aluminium, acier	1 pce

Novaloc™- accessoirs spéciaux

Image	Réf.	Désignation	Spécifications	Nombre
	2010.703	**Boîtier de matrice en titane avec option de fixation** (avec unité de montage en noir) -désinfectable-	Matrice: titane Unité de montage: PEEK	4 pces
	2010.710	**Elément de rétention rouge** -désinfectable-	PEEK (P) Force de retention: ***extra-light***	4 pces
	2010.715	**Elément de rétention noir** -désinfectable-	PEEK (P) Force de retention: ***ultra-strong***	4 pces

Composants du système Novaloc™

Image	Réf.	Désignation	Nombre
	2010.101	**Boîte d'équipement avec 3 outils**	
	2010.731	Instrument de retrait des unités de montage + instrument facilitant le repositionnement des analogues (bleu)	1 pce
	2010.741	Instrument de mise en place et de retrait des unités de rétention (brun)	1 pce
	2010.751	Extracteur de boîtier de matrice (gris)	1 pce
	2010.201	**Contenu initial de la boîte d'équipement**	
	2010.701	Boîtier de matrice en titane, avec unité de montage	4 pces
	2010.702	Boîtier de matrice en PEEK, avec unité de montage	4 pces
	2010.711	Élément de rétention blanc *light*	4 pces
	2010.712	Élément de rétention jaune *medium*	4 pces
	2010.713	Élément de rétention vert *strong*	4 pces
	2010.714	Élément de rétention bleu *extra-strong*	4 pces
	2010.721	Réplique de pilier, Ø4 (bleu)	4 pces
	2010.722	Matrice d'empreinte/fixation (rouge)	4 pces
	2010.723	Insert de doublage (blanc)	4 pces
	2010.724	Anneau de montage en silicone	10 pces
Titane	**2010.601**	**Ensemble titane**	
	2010.701	Boîtier de matrice en titane, avec unité de montage	2 pces
	2010.711	Élément de rétention blanc *light*	2 pces
	2010.712	Élément de rétention jaune *medium*	2 pces
	2010.713	Élément de rétention vert *strong*	2 pces
	2010.724	Anneau de montage en silicone	2 pces
PEEK	**2010.611**	**Ensemble PEEK**	
	2010.702	Boîtier de matrice en PEEK, avec unité de montage	2 pces
	2010.711	Élément de rétention blanc *light*	2 pces
	2010.712	Élément de rétention jaune *medium*	2 pces
	2010.713	Élément de rétention vert *strong*	2 pces
	2010.724	Anneau de montage en silicone	2 pces

PRÉPARATION/ STÉRILISATION

L'utilisateur est responsable de la maintenance et du contrôle réguliers des appareils de nettoyage, de désinfection et de stérilisation ainsi que des validations correspondantes.

Pour tous les paramètres non spécifiés (par exemple pression et durée), on appliquera les instructions du fabricant de l'appareil de nettoyage, de désinfection ou de stérilisation.

Toutes les surfaces doivent être accessibles au produit de désinfection / stérilisation.

Remarque:

Les composants Novaloc™ ne doivent jamais être exposés à une stérilisation par vapeur d'eau, étant donné que la stabilité de la forme est réduite aux températures élevées et que les éléments ainsi traités seraient par conséquent probablement déformés.

Désinfection

Pour la désinfection, les composants Novaloc™ doivent être disposés séparément sans être empilés et de façon à ne pas se toucher, afin que toutes les surfaces soient accessibles au désinfectant.

Lors d'une préparation/désinfection manuelle des composants Novaloc™, la solution utilisée doit être contrôlée chaque jour (chargement de saleté). En règle générale, les solutions désinfectantes doivent être renouvelées chaque jour, sauf si le producteur du désinfectant indique une plus longue durée d'utilisation confirmée par un rapport d'expertise. Les concentrations et durées d'immersion indiquées par le producteur du désinfectant doivent être strictement respectées.

Les composants Novaloc™ utilisés doivent être transférés de la zone de traitement des patients à la zone de traitement du matériel. Tout d'abord, il faut – en appliquant les mesures de précaution qui s'imposent (par exemple port de gants et de lunettes de protection) – éliminer prudemment les saletés grossières éventuellement présentes, par exemple en essuyant les pièces à nettoyer avec un tampon de gaze ou en les rinçant à l'eau courante.

Les composants Novaloc™ démontables doivent être démontés avant la poursuite de leur traitement. Pour éviter qu'ils sèchent, les dispositifs médicaux doivent être immergés avec précaution immédiatement dans la solution de traitement (bac à instruments avec panier et couvercle), en veillant à ce qu'ils soient entièrement couverts de solution sans qu'il reste des bulles d'air emprisonnées.

Stérilisation

Les instruments Novaloc™ neufs doivent être nettoyés avant la désinfection ou la stérilisation à la vapeur.
Les instruments Novaloc™ déjà utilisés ne peuvent pas être stérilisés dans la pochette de protection fournie avec les produits.

Pour la stérilisation à la vapeur d'eau, il est recommandé d'utiliser une température de 134 °C + 3 °C (273,2 °F + 5,4 °F/ 407,15 K + 3K) pour une durée de 18 minutes.

RISQUES

Risques lors de la préparation/stérilisation

Seuls des instruments Novaloc™ absolument propres peuvent être utilisés!

Les instruments Novaloc™ ne doivent pas entrer en contact avec des produits contenant du chlore ou du fluor.

Les pièces faites d'aluminium ou d'un matériau contenant de l'aluminium ne doivent à aucun moment entrer en contact avec des produits contenant du mercure. Déjà des traces minimes de mercure peuvent provoquer une corrosion considérable. Les solutions nettoyantes ou désinfectantes utilisées pour frotter, nettoyer ou immerger les instruments Novaloc™ faits de matériaux contenant de l'aluminium doivent présenter un pH compris entre 4,5 et 8,5. Au contact avec des solutions présentant un pH supérieur ou inférieur, la couche protectrice passive des matériaux contenant de l'aluminium se dissout et cela entraîne une corrosion.

Les instruments Novaloc™ réutilisables doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés directement après leur utilisation.

Les saletés ne doivent pas avoir l'occasion de sécher sur les instruments Novaloc™, étant donné que cela rend le nettoyage plus difficile.

Les instruments Novaloc™ ne doivent pas être immergés dans une solution saline physiologique, étant donné qu'un contact prolongé avec une telle solution est susceptible de provoquer une corrosion et une détérioration des surfaces.

Les solutions de nettoyage et de stérilisation doivent toujours être fraîchement préparées.

Le nettoyage des instruments ne doit jamais être fait avec une brosse métallique ou un produit nettoyant abrasif.

Pour les instruments Novaloc™ qui présentent des cavités, il faut s'assurer spécialement avant la stérilisation que ces cavités ne contiennent aucun résidu.

Risques avec le système Novaloc™

Utilisation des instruments Novaloc™

Les risques généraux lors de l'utilisation d'instruments Novaloc™ englobent des réactions allergiques au matériau des instruments ainsi qu'une désolidarisation, une usure, une corrosion et un vieillissement de parties des instruments.

S'ils sont manipulés de façon inadéquate ou endommagés, les instruments Novaloc™ peuvent subir une corrosion, une oxydation, une usure excessive ou une altération de leur fonction.

Les instruments peuvent présenter des bords tranchants ou des extrémités pointues. Lors d'une utilisation de gants de protection, ces derniers peuvent être endommagés. Il faut tenir compte du risque d'infection.

Utilisation des composants Novaloc™

Il n'existe pas de risques actuellement connus dus aux composants Novaloc™.

Si des complications ou des douleurs inattendues apparaissent, il faut immédiatement consulter le dentiste traitant ou le technicien-dentiste.

MARCHE À SUIVRE

Boîtier de la matrice Novaloc™ (titane/ PEEK)

Fig.3

Le boîtier de la matrice Novaloc™ est disponible en titane [Fig.3] et en matière synthétique beige (PEEK) [Fig.4].

La matrice de titane peut être utilisée comme à l'habitude.



Fig.4

La version en matière synthétique beige (PEEK) est utilisée lors d'une position extrêmement labiale ou buccale de l'élément Locator® (pas de tatouage gris) et dans le cadre de la médecine dentaire holistique exigeant un traitement sans aucune utilisation de métaux.

Unité de montage Novaloc™ (PEEK/ couleur noire)

Fig.5

L'unité de montage noire [Fig.5] sert à protéger la configuration intérieure du boîtier de la matrice et à fixer le boîtier de la matrice pendant la fabrication de la restauration.

Grâce à l'excellent niveau d'ajustement et de fonctionnalité, l'unité de montage permet un positionnement précis de la matrice sur le bouton-pression Locator® et empêche toute pénétration de matière synthétique dans le boîtier de la matrice lors de l'inclusion au polymère.

L'unité de montage ne peut et ne doit être retirée au moyen de l'instrument Novaloc™ de retrait pour unité de montage [Fig.6.1] [Fig.6.2] qu'après l'inclusion de la matrice au polymère de la prothèse dentaire.

Fig.6.1

<u>Retirer l'unité de montage avec l'instrument de retrait version 1</u>
(à partir de 11/2012)

1. Utiliser l'extrémité inox de l'instrument de retrait [Fig.6.1.1]
2. L'extrémité en forme d'un pied de l'instrument Novaloc™ de retrait est insérée dans l'unité de montage [Fig.6.1.2]. L'extrémité inox de l'instrument possède un repère sous forme d'encoche qui sert du guide d'orientation [Fig.6.1.1]. Insérer le pied d'extraction dans le trou au bas de l'unité de montage [Fig.6.1.3].
3. Incliner l'instrument de retrait contre l'extrémité en forme d'un pied, puis retirer l'unité de montage du boîtier de la matrice en tirant [Fig.6.1.4]

Fig.6.1.1

Fig.6.1.2



Fig.6.1.3



Fig.6.1.4

Fig.6.2

Retirer l'unité de montage avec l'instrument de retrait version 0

1. Utiliser l'extrémité inox de l'instrument de retrait [Fig.6.2.1]
2. L'extrémité en forme de bec de l'instrument Novaloc™ de retrait, portant un marquage au laser, est insérée dans la cannelure circulaire de l'unité de montage à un endroit quelconque de l'anneau saillant [Fig.6.2.2] [Fig.6.2.3]
3. Incliner l'instrument de retrait contre l'extrémité en forme de bec, puis retirer l'unité de montage du boîtier de la matrice en tirant [Fig.6.2.4]

Fig.6.2.1

Fig.6.2.2



Fig.6.2.3



Fig.6.2.4

Unités de rétention Novaloc™ (PEEK)

Fig.7



Force de rétention:
light
env. 750g



Force de rétention:
medium
env. 1200g

Force de rétention:
strong
env. 1650g

Force de rétention:
extra-strong
env. 2100g

En tant qu'éléments de fixation, la matrice Novaloc™ dispose de quatre éléments de rétention qui correspondent à différentes forces de rétention et sont identifiables grâce à un code couleurs [Fig.7].

Fig.8

Ces éléments sont placés au choix dans le boîtier de la matrice après le retrait de l'unité de montage. Ceci peut être fait à l'aide de l'instrument Novaloc™ de mise en place et de retrait [Fig.8], qui permet une manipulation aisée. De cette façon, les éléments de rétention peuvent être changés sans contrainte et sans être endommagés.

La mise en place:

Fig.8.1

Fig.8.2

Fig.8.3

Fig. 8.4

1. Utiliser le tampon métallique de l'instrument pour prendre l'élément de rétention choisi dans la boîte d'équipement. On ressent légèrement l'emboîtement de l'élément de rétention sur l'extrémité de l'instrument. [Fig.8.1;8.2]
2. Presser l'élément de rétention dans le boîtier de la matrice en orientant l'instrument parallèlement au boîtier de la matrice. On ressent l'emboîtement et on entend un «clic»! [Fig.8.3;8.4]

Le retrait:



Fig.8.5

Fig.8.6

Fig.8.7

1. L'autre extrémité métallique de l'instrument est orientée parallèlement à la matrice et placée sur la surface externe de l'élément de rétention en exerçant une légère pression sans utiliser de force. On ressent l'emboîtement et on entend un «clic». L'utilisation d'un binoculaire est préférable pour l'exécution de ce geste. [Fig.8.5;8.6;8.7]
2. L'élément de rétention est ainsi déverrouillé et peut aisément être retiré du boîtier de la matrice par un léger mouvement tournant. [Fig.8.7]
3. Pour détacher ensuite l'élément de rétention de l'instrument de retrait, la boîte d'équipement offre deux dispositifs de détachement prévus à cet effet. L'élément de rétention doit être poussé dans le creux du dispositif. [Fig.8.8]
4. Une inclinaison latérale permet alors de détacher l'élément de rétention de l'instrument. [Fig.8.9]

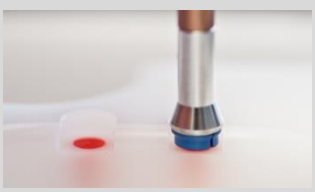

Fig.8.8

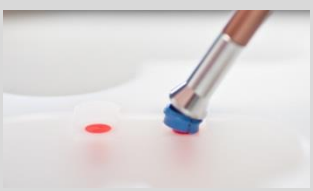

Fig.8.9

Matrice d'empreinte/fixation Novaloc™ (PEEK/ rouge)



Fig.9

La matrice d'empreinte/fixation Novaloc™ rouge [Fig. 9] présente une hauteur légèrement supérieure à celle de la matrice Novaloc™ complète. Ce facteur crée des conditions claires et une bonne vue d'ensemble lors du report et de la prise d'empreinte dans les prothèses existantes, pour voir si la matrice Novaloc™ aura suffisamment de place en présence d'armatures métalliques, de dents artificielles, etc. [Fig. 9.1].

La Matrice d'empreinte/fixation Novaloc™ est placée dans la bouche sur le pilier Locator® [Fig. 9.2]. Un clic audible et un emboîtement perceptible confirment la bonne assise de la matrice d'empreinte/fixation. On procède ensuite comme à l'habitude pour la surempreinte.

En raison de son faible besoin de place, la matrice Novaloc™ d'empreinte/fixation peut aussi parfaitement servir de matrice de fixation pour l'enregistrement de l'occlusion, les gabarits, les appareils dentaires, les restaurations provisoires, etc. [Fig. 9.3]

Fig.9.1

Fig.9.2

Fig.9.3

Insert de doublage Novaloc™ (POM C/ blanc)

Fig.10

Lors de la création de prothèses coulées sur modèle ou d'armatures métalliques coulées, l'insert de doublage Novaloc™ blanc [Fig.10] permet grâce aux dimensions légèrement agrandies de la matrice [Fig.10.1] de créer idéalement la place pour la fixation ultérieure de la matrice originale dans la prothèse dentaire à l'aide de matière synthétique ou d'un adhésif [Fig.10.2;10.3].

Les surfaces extérieures de l'insert de doublage sont très légèrement angulées, ce qui permet d'obtenir un espace auto-rétentif pour recevoir le boîtier de la matrice dans le métal lors de la création de prothèses coulées sur modèle ou d'armatures métalliques coulées.

Fig.10.1

Fig.10.2

Fig.10.3

Disque de montage Novaloc™ (silicone/ couleur blanche)

Fig.11

Le disque de montage Novaloc™ blanc [Fig.11] est utilisé lors d'une fixation directe de la matrice dans la bouche du patient.

Le disque de silicone est alors placé sous la structure rétentive du bouton-pression Locator® [Fig.11.1] et poussé au ras de la matrice à coller.

Cela permet d'éviter qu'un excès de matière synthétique ou d'adhésif puisse s'adapter au col cylindrique du pilier Locator®, ce qui provoquerait une fixation permanente de la prothèse dentaire au pilier Locator® vissé dans la bouche.

Fig.11.1

La règle suivante est applicable lors d'un montage direct des matrices dans la bouche:

Mieux vaut utiliser trop peu que trop de matière synthétique ou d'adhésif. Cela signifie qu'il faut éviter un excès.

La réalisation d'un ajout éventuellement nécessaire hors de la cavité buccale est la méthode la plus sûre pour éviter une fixation permanente indésirable dans la bouche!

Analogue Novaloc™ (aluminium/ couleur bleue)



Fig.12

L'analogue Novaloc™ bleu [Fig.12] présente au niveau du col une masse identique à celle du pilier Locator® original, ce qui garantit qu'aucune irritation ne sera provoquée par la masse d'empreinte lors du repositionnement de l'analogue de modèle. [Fig.12.6]



Fig.12.1

En tant qu'aide pour le positionnement de l'analogue dans l'empreinte, on dispose dans le cadre de l'équipement Novaloc™ de l'instrument de repositionnement pour analogue [Fig.12.1], offrant une sécurité absolue de manipulation. [Fig.12.2;12.3;12.4;12.5;12.6]

Fig.12.2

Fig.12.3

Fig.12.4

Fig.12.5

Fig.12.6

Extracteur Novaloc™ pour boîtier de matrice + dispositif de retrait (gris)- uniquement pour boîtier titane-

Fig.13

L'extracteur Novaloc™ pour boîtier de matrice séduit par sa simplicité et son efficacité. [Fig.13]

Les 3 points du procédé d'utilisation:



Fig.13.1

1. Chauffer la tête d'extraction avec une flamme. [Fig.13.1]

Fig.13.2

2. Mettre l'extrémité en forme de bec de l'extracteur Novaloc™ en place à un endroit quelconque de la cannelure circulaire du boîtier de la matrice, puis laisser agir 2 à 3 secondes la chaleur de la tête d'extraction chauffée sur le fond de la matrice. [Fig.13.2]

Fig.13.3

3. Faire levier avec l'extracteur Novaloc™ en l'inclinant contre l'extrémité en forme de bec, puis retirer l'extracteur avec le boîtier de la matrice. [Fig.13.3]

Procédé d'utilisation du dispositif de retrait:

Fig.13.4

Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé de ne pas procéder au retrait des éléments de rétention depuis la boîte d'équipement, cette procédure prévient toute contamination des éléments de rétention se trouvant dans cette boîte.

1. Une rainure est dessinée à l'extrémité de la poignée pour détacher l'élément de rétention extrait de l'implant dentaire de l'instrument de retrait. L'élément de rétention doit être inséré dans la rainure du dispositif [Fig.13.4]
2. Une inclinaison latérale permet de désolidariser l'élément de rétention de l'instrument.

Boîte d'équipement Novaloc™ avec son contenu initial

La boîte d'équipement Novaloc™ spécialement conçue pour le dentiste et le technicien-dentiste [Fig. 14] se distingue par son agencement bien structuré, pratique pour l'utilisateur. Elle contient toutes les parties du système et les outils appropriés pour leur utilisation.

La construction de la boîte empêche que le contenu puisse passer d'un compartiment à l'autre lorsque le couvercle est fermé.

De plus, cette boîte est faite d'un matériau extrêmement résistant aux chocs et aux ruptures afin de satisfaire pleinement aux exigences usuelles au cabinet du dentiste et au laboratoire.

Fig. 14

Novaloc™- accessoirs spéciaux

Boîtier de matrice en titane avec option de fixation:



Fig.15

Le boîtier de matrice en titane avec option de fixation est indiqué pour les cas de piliers profondément enfouis sous la gencive, ou lorsque la hauteur des piliers n'est pas idéale.
Grâce aux deux niveaux de fixation, la hauteur de la matrice peut être ajustée individuellement (un disque carborundum peut être utilisé pour sectionner la rétention au niveau de la rainure), et une excellente tenue est ainsi assurée dans la prothèse. [Fig.15]

Elément de rétention rouge:

Fig.16

L'élément de rétention rouge [Fig.16] est le plus souple élément de rétention.

Force de rétention: ***extra-light*** (env. 300g)

Elément de rétention noire:

Fig.17

L'élément de rétention noire [Fig.17] est utilisé dans les situations extrêmes, et il est recommandé pour les situations suivantes:

- Pilier souffrant d'une forte usure.
- Travail prothétique avec un unique élément de rétention.

Force de rétention : ***ultra-strong*** (env. 2550g)

LÉGENDE MATÉRIAUX

Abrév.	Nom	Propriétés physiques								Propriétés mécaniques	Informations sur l'utilisation Possibilités de liaison					
		Couleur	Composition						Intervalle de fusion	Limite d'élasticité à 0.2 % (Rp 0.2 %)	Coulée de raccord	Brasage	Soudage au laser	Soudage au phaser	Collage	Polymérisable
T	**Titan pur**	Gris	C % (max.) 0.08	Fe % (max.) 0.5	O % (max.) 0.4	N % (max.) 0.05	H % (max.) 0.0125	Ti % valeur restante	1600 – 1700°C	≥ 520 MPa			✓	✓	✓	✓
P	**PEEK**	Diverses	Polyetheretherketon 100 % Plastique complétement calcinable													